

**SISTEMA INFORMATIZADO DE
REGULAÇÃO E CONTROLE
DO ICS**

**MANUAL DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
CONSULTÓRIOS/CLÍNICAS/HOSPITAIS
CREDENCIADOS PARA REALIZAÇÃO DE
OPME**

Na ABA Selecionar Serviços, selecione a opção REALIZAÇÃO DE OPME.

Após clique em **Avançar**

Selecionar Serviço Ambulatorial

Beneficiário(a):

- Guia De Consulta
- Guia De Solicitação De SP/SADT
- Guia De Solicitação De Internação
- Guia De Solicitação De Quimioterapia
- Guia De Solicitação De Radioterapia
- Guia De Solicitação De OPME
- Realização De OPME
- Realização De SP/SADT
- Consultar As Últimas Guias Geradas
- Histórico Pendências

Avançar

Na tela REALIZAÇÃO DE OPME, clicar em **Fornecedor material** ;

Realização De OPME


Guia OPME	Solicitação	Validade	Situação	Tipo Solicitação	Guia Principal
14661986	01/08/2022	30/10/2022	Liberada	INTERNAMENTO	14661979

Materials OPME:

Código	Descrição OPME	Ordem	Qt.Sol	Vlr.Un R\$	Qt.Aut	Vlr.Un R\$	Autorização
100099203	STENT CORONÁRIO MGuard PRIME - MGP3523	1	1	360,00	1	360,00	
100911692	ANGIOSCULPT SCORING BALLOON PERIFÉRICO 0.014" MÉDIO	1	1	232,00	1	232,00	
101044550	Alça de Ressecção Eletrocirúrgica - PFS02-02023080	1	1	1.000,00	1	1.000,00	


Realizar Guia Fornecedor material

Voltar

Na tela FORNECEDOR MATERIAL OPME, informar o CNPJ do FORNECEDOR, clicar em  e selecionar o material a ser atribuído ao fornecedor.

Fornecedor material OPME

Beneficiário(a): Guia OPME:


CNPJ  Fornecedor

Todos os materiais Materiais atribuídos Materiais não atribuídos

<input type="checkbox"/>	Código	Descrição OPME	Fornecedor	Ordem
<input type="checkbox"/>	100458920	PONTEIRAS DE ABLAÇÃO LINVATEC - 9735BA		1
<input type="checkbox"/>	100556930	Ucla Provisória - Ucla Provisória HE 4.1 RT com Parafuso Sextavado		1
<input type="checkbox"/>	100881742	Alça para Polipectomia a Frio Exacto		1

+ Atribuir fornecedor ✖ Remover fornecedor

Clicar em



O Sistema emitirá uma caixa de mensagem, informando para qual fornecedor e material atribuído. Se estiver correto clicar em **SIM**.




Após clicar em **X** ou



Na Tela de Realização de OPME, clicar em



;

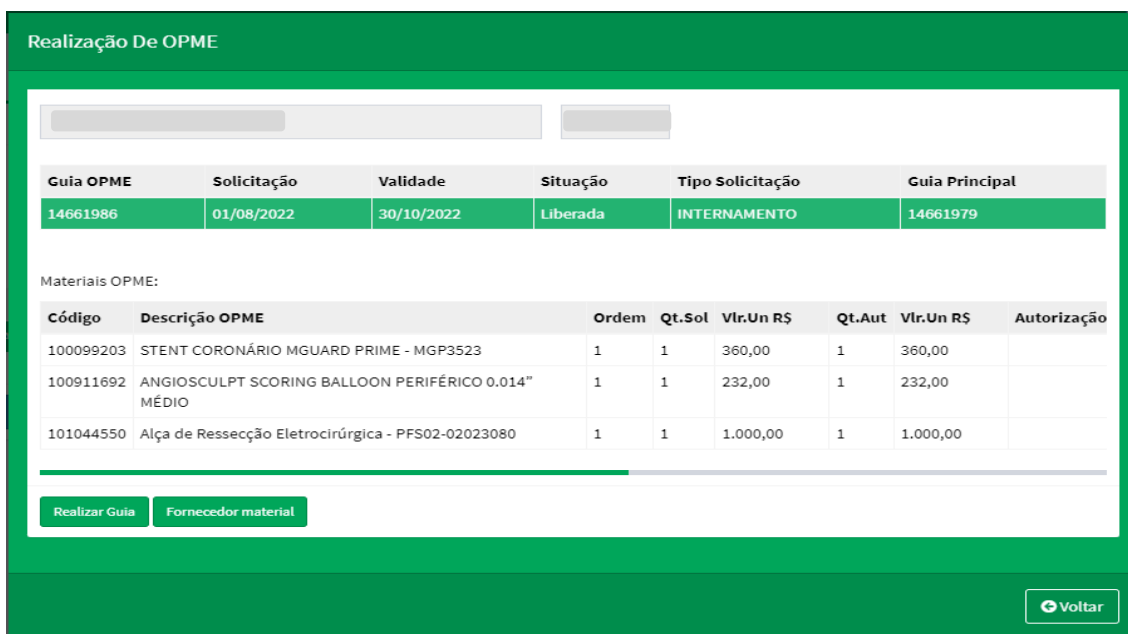

Após o Sistema emitirá uma caixa de mensagem solicitando a confirmação da Guia de OPME, caso esteja tudo correto clica em **SIM**.

ATENÇÃO! ×

Deseja confirmar a realização da guia OPME de número:

Não **Sim**

Atenção! ×

Realização da guia efetuada com sucesso!

Clique em 'OK' para imprimir.

OK